


回答書

令和7年(2025年)8月15日

小田原市立病院新病院中央材料室及び手術室滅菌業務公募型プロポーザル実施要領「7 質疑書」の規定するところにより、次の事項について回答します。

No.	項目	質疑内容	回答
1	業務内容説明書 6 業務実施日時 (2)	翌日必要器材の滅菌処理のため、現状、午後10時を超過して業務を実施している場合がありますが、器材の追加購入の予定はございますでしょうか。	器材不足解消は随時、購入又は購入を検討している状況です。
2	業務内容説明書 16 提出書類一覧 No.9 業務従事者教育研修年次計画書 No.10 業務従事者教育研修報告書	教育研修に使用するツール及び内容に関しては社内で定めたものであり、発注者に承認いただいたものを使用する認識でよろしいでしょうか。また具体的な内容は滅菌業務、手術室補助業務に関する内容及び患者個人情報保護の観点からプライバシーマークに準ずる教育を実施する認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。 当該業務を実施するにあたり必要と考える研修の計画を立て提出いたします。
3	業務内容説明書 別紙1-1 3 (8) 消毒処理器材について	現状消毒処理器材の量が多くありますが、ディスプレイへの移行予定はございますでしょうか。	随時、検討している状況です。
4	業務内容説明書 別紙1-3 4 (7) 換気口の定期清掃(月1回)	具体的にはどのような形状で何方の清掃が必要でしょうか。また清掃は換気口外面の取り外しを行い内部まで必要でしょうか。もしくは表面のみでよろしいでしょうか。	手術室内のヘパフィルタ付きの換気口、エアコン、通常の換気口(吸出口・吹出口)を含め174箇所となります。手術室内のヘパフィルタ付きの換気口については、1室に対し部屋の四隅と天井で計5箇所となっており、これに関しては取り外して清掃していただく想定です。取り外す換気口の形状について、一般的な手術室と相違ないもので、部屋の四隅の換気口については、ガラリのような形状を想定しています。(別紙:参考図面参照)
5	業務内容説明書 別紙1-3 4 (9) 床面の定期清掃(年2回)	洗浄剤を用いた表面洗浄と、ワックス塗布の認識でよろしいでしょうか。また、エリアを分けて年2回で全体を実施する認識でよろしいでしょうか。	ノンワックスタイプの床材のため、ワックス塗布は不要とし、表面洗浄のみとします。エリア全体の床面の清掃を完了することを1回とし、これを1年に2回行うものです。この1回の清掃に際して複数日に分けて実施することは問題ありません。 ※2回に分けてエリア全体の床面清掃を行うものではありません。
6	実施要領 6 (1) 様式1、様式2	代表者名は社長印か支店長印どちらが必要となりますでしょうか。	契約時に署名・押印するものと同一の署名・押印により、書類を作成してください。
7	実施要領 6 (1) 様式3、様式4、様式6	全社の内容を記載する形でよろしいでしょうか。もしくはプロポーザル参加拠点の内容でしょうか。	会社全体の実績を記載することを想定した様式としています。
8	実施要領 6 (1) 様式4	金額の記載は必須でしょうか。 延床面積はオペ室内か院内全てどちらが必要でしょうか。	契約規模の確認及び実績評価をするため、全ての項目について記載してください。また、床面積は回答不要とします。
9	実施要領 6 (1) 様式3	キャッシュフロー計算書を作成しておらず損益計算書・賃借対照表のみの提出でもよろしいでしょうか。	損益計算書・賃借対照表のみ提出してください。
10	業務内容説明書 別紙1-3 4 (9) 床面の定期清掃(年2回)	床面は、ノンワックス素材でございますか。 もしくは、定期清掃にワックス塗布を含めますか。	ノンワックスタイプの床材のため、ワックス塗布は不要とし、表面洗浄のみとします。
11	その他	開院に向けて、新規購入される器械はございますでしょうか。また、購入された器械の油抜きといった使用前洗浄は既存病院での実施予定でございますでしょうか。若しくは新病院での実施想定でございますでしょうか。	新病院開院に合わせた物品の購入に関する入札は未実施のため、回答を控えさせていただきます。 購入した器械の油抜きの使用前洗浄は、既存病院で実施しています。
12	業務内容説明書 別紙1-3 8 ピッキング業務	SPD業者業務終了後とございますが今時点で、終了時間はお決まりでしょうか。また、院内滅菌物のピッキング業務はSPD業者の委託範囲という認識で問題ございませんでしょうか。	新病院におけるSPD仕様書、受託業者が未決定のため、回答を控えさせていただきます。 院内滅菌物のピッキング業務は、SPD業者の委託範囲という認識で問題ありません。
13	その他	院内に酸化エチレンガス滅菌装置はございませんが、もし酸化エチレンガス滅菌処理が必要になった場合は、別途病院様より、院外滅菌業者へ委託される運用のご認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。 別の装置ですが、新病院においてはホルマリン滅菌装置1台、低温プラズマ滅菌装置1台の設置を予定しています。

天井面吹出口位置図

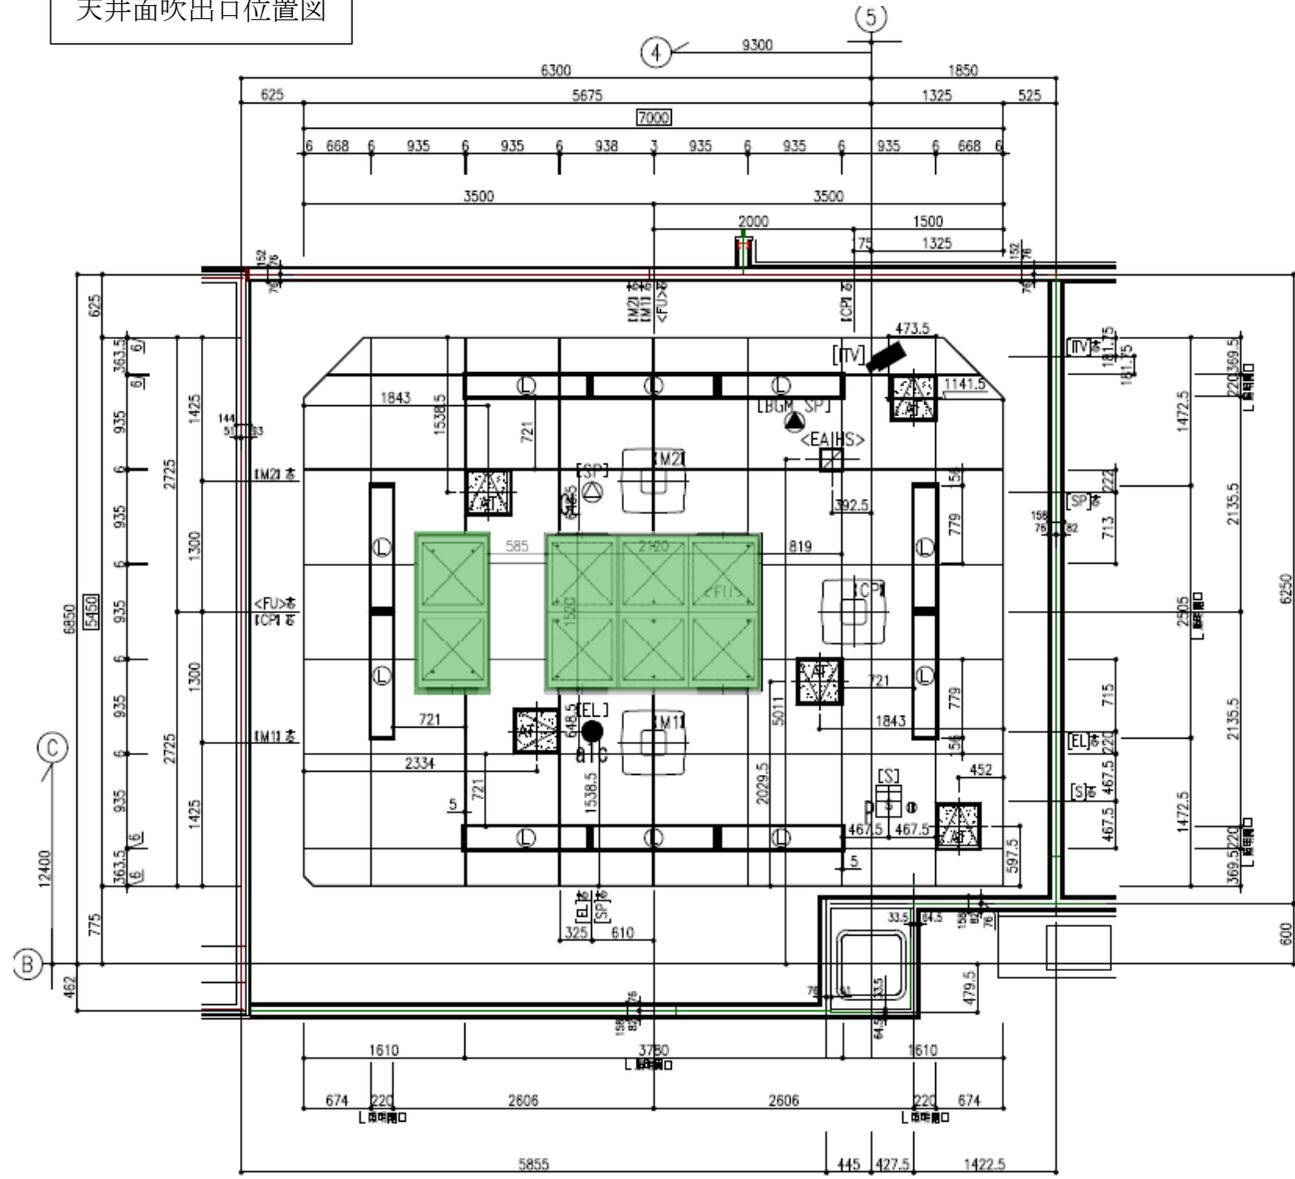

※天井面吹出口について、図面上の☒は8つ記載されていますが、回答書ではこれを1箇所として積算しています。また、手術室の広さに応じて☒の数や位置が異なります。